




广州检验检测认证集团有限公司

# 检测报告

报告编号: GZGC-2017-000001

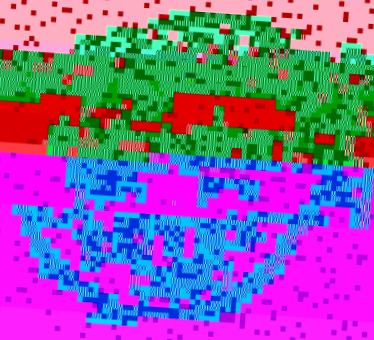

## 複發通知

1. 本報告只對本檢驗項目之檢驗結果負責，不負責：

2. 本報告的檢驗結果與本報告所附之檢驗單無關，本報告與檢驗單均不具法律責任，本報告與檢驗單均不具法律責任。

3. 本報告之檢驗結果，不具法律責任。

### 複發通知

1. 本報告只對本檢驗項目之檢驗結果負責，不負責：

2. 本報告塗改無效，無審核、簽發人簽字無效。

3. 本報告無本機構檢測章印者，即屬無效。

4. 本報告之檢驗結果，不具法律責任，本報告與檢驗單均不具法律責任。

本報告之檢驗結果

檢驗地址：廣州白雲區江滘鎮廣德隆路100號

檢驗日期：2024年10月



檢驗地點：廣州白雲區江滘鎮廣德隆路100號

檢驗日期：2024年10月

檢驗地點：廣州白雲區江滘鎮廣德隆路100號

簽發人



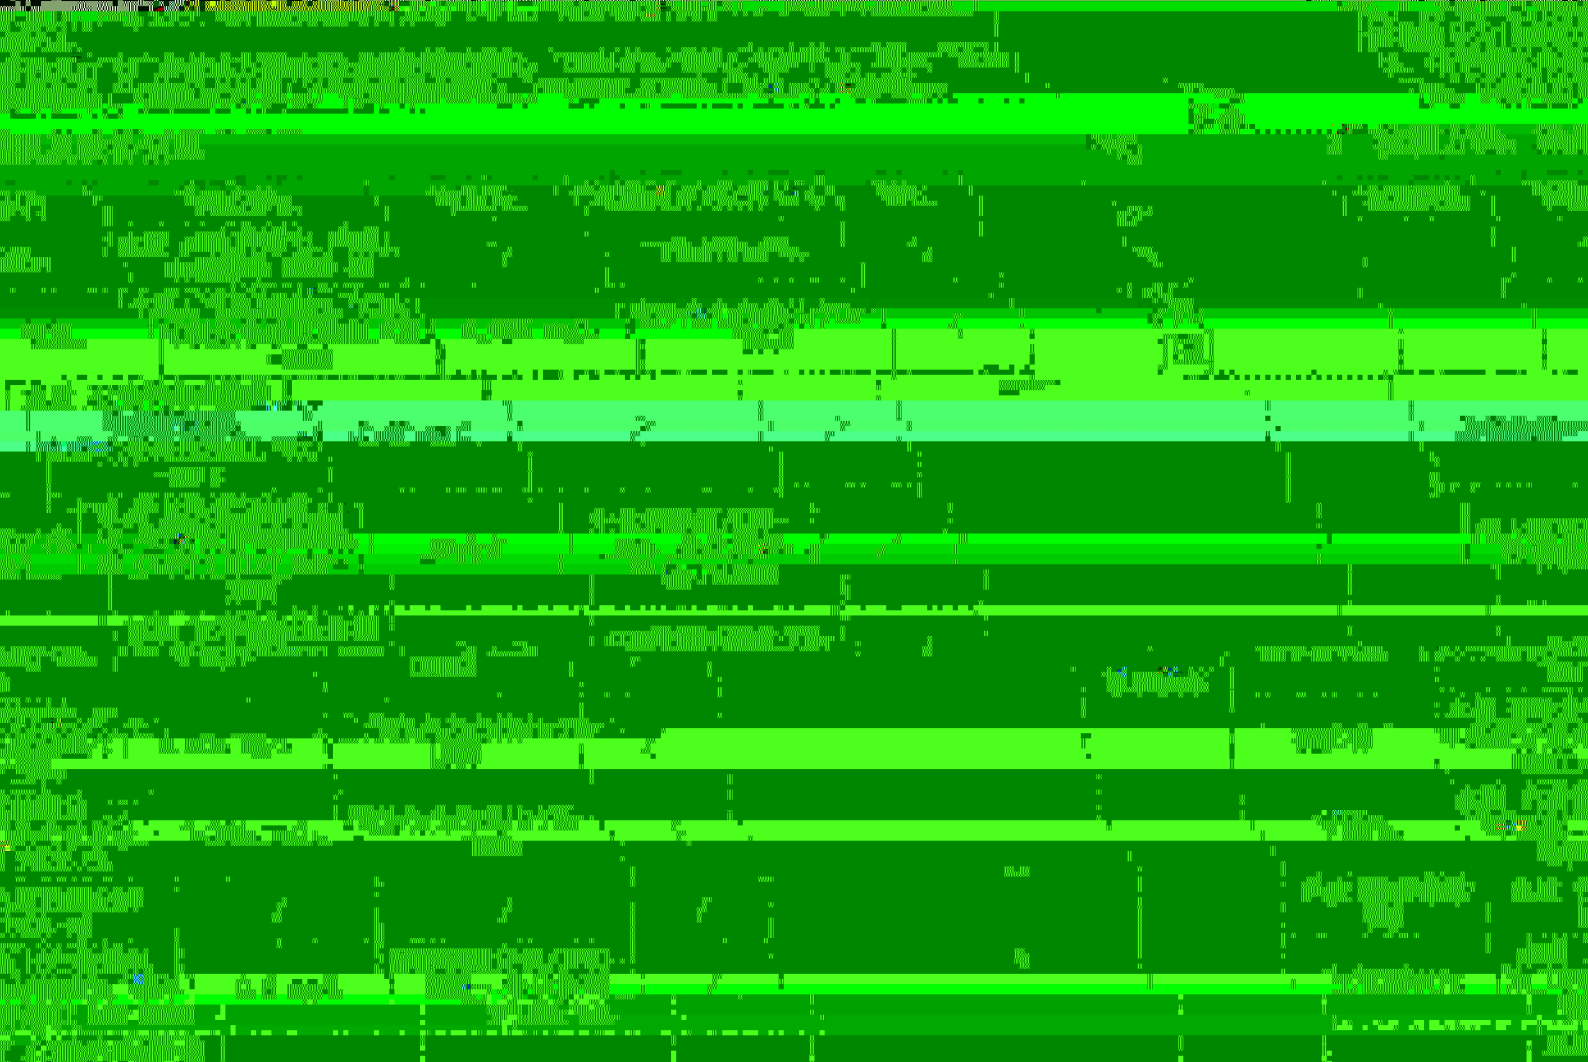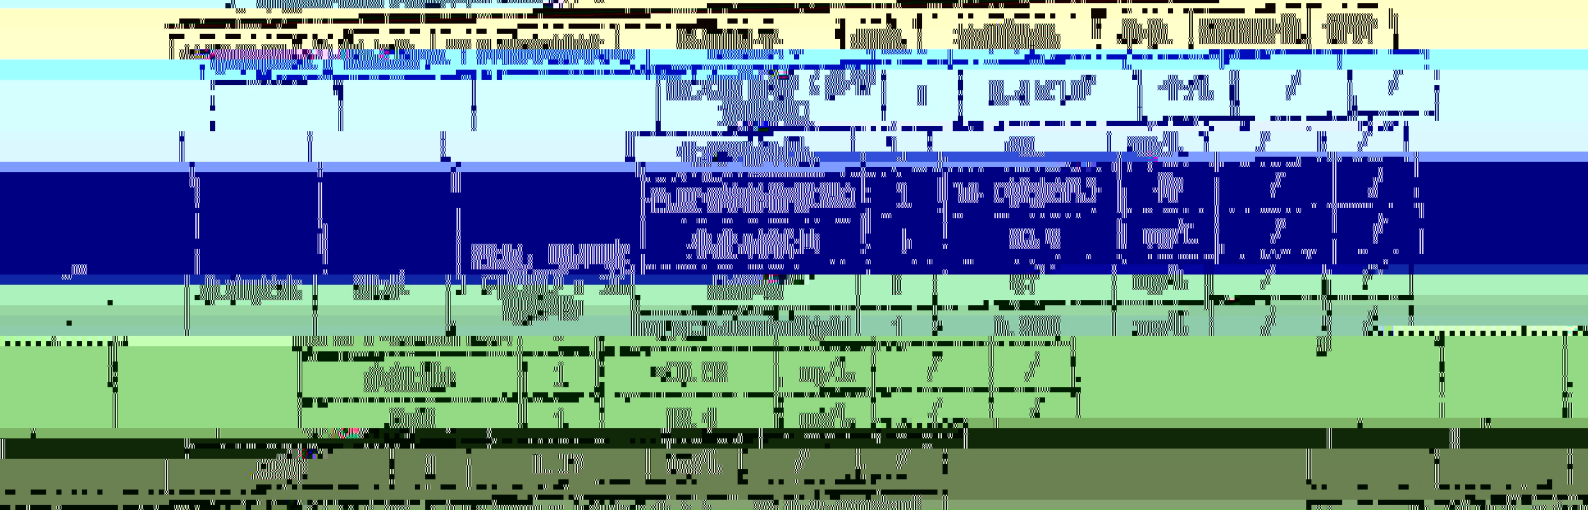

（增补附件）  
火焰原子吸收法(B)

原子吸收光谱

序号	名称	规格	品牌	数量	单位	备注
1	原子吸收光谱仪	AA-7000	岛津	1	台	
2	石墨炉	GF-1000	岛津	1	台	
3	氢化物发生器	HG-1000	岛津	1	台	
4	砷化氢发生装置	AS-1000	岛津	1	台	
5	空气压缩机	AC-1000	岛津	1	台	
6	氮气发生器	NG-1000	岛津	1	台	
7	氩气发生器	AR-1000	岛津	1	台	
8	蠕动泵	MB-1000	岛津	1	台	
9	进样器	IS-1000	岛津	1	台	
10	雾化器	WZ-1000	岛津	1	台	
11	燃烧器	CB-1000	岛津	1	台	
12	检测器	DC-1000	岛津	1	台	
13	计算机	CP-1000	岛津	1	台	
14	打印机	PR-1000	岛津	1	台	
15	试剂	RE-1000	岛津	1	瓶	
16	标准溶液	ST-1000	岛津	1	瓶	
17	器皿	CR-1000	岛津	1	套	
18	耗材	CH-1000	岛津	1	套	

2019年5月15日